

**Français**

• Vous pouvez également interrompre un cycle de polymérisation en cours en appuyant sur le bouton de marche/arrêt. Si tel est le cas, appuyez une fois sur le bouton de marche/arrêt pour redémarrer l'appareil.

**Attention :** Si le **MultiSpot®** commence à clignoter, la batterie doit être rechargeée. Si on continue à utiliser le **MultiSpot®**, la batterie peut être complètement déchargée. En ce cas, un rechargement n'est plus possible. La batterie est alors défectueuse et doit être remplacée ce qui entraîne une perte de garantie.

**Tenez l'appareil hors de portée des enfants !**  
Uniquement pour application dentaire sur les modèles

#### État de livraison

REF D38110

**MultiSpot®**  
1 lampe manuelle **MultiSpot®**  
1 batterie Li-ion 3,7 V / 3100 mAh  
1 chargeur  
1 notice d'utilisation

#### Accessoires

REF D38111 Écran protecteur anti-éblouissement  
3 pièces  
REF D38112 Batterie Li-ion 3,7 V / 3100 mAh  
1 pièce  
REF D38113 Chargeur 1 pièce

Le produit a été développé pour utilisation en dentisterie et doit être utilisé conformément aux consignes et instructions d'utilisation fournies. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de la mauvaise utilisation ou d'une application inadéquate. L'utilisateur est également tenu avant de tester le produit avant de l'utiliser, sous sa propre responsabilité pour en déterminer l'application et la possibilité d'utilisation aux fins prévues, en particulier si l'application visée n'est pas mentionnée dans la brochure.

**Élimination selon la directive WEE**  
La directive européenne 2002/96/CE pour la réduction de la quantité croissante de déchets électroniques des équipements électriques et électroniques qui ne sont plus utilisables. L'objectif est la prévention, la réduction et l'élimination rationnelle des quantités de plus en plus nombreuses de déchets électriques et électroniques. L'élimination des appareils étiquetés en conséquence ne doit pas se faire avec les ordures ménagères, mais professionnellement par le biais de la collecte communale, votre revendeur ou le fabricant.

Date des informations : 05 / 2017 / CL


## Español

### Instrucciones de trabajo

(ES)

#### MultiSpot®

##### Botón de encendido

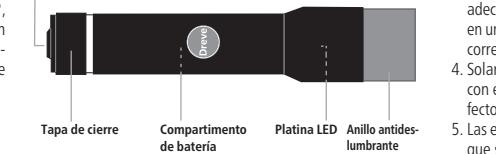

##### Indicaciones

El aparato de polimerización **MultiSpot®** manual ha sido concebido especialmente para la fijación y polimerización previa de todos los materiales fotopolimerizables que se usan en laboratorio. Dado su sistema DWL, este aparato manejable sin cable es ideal sobre todo para composites, material de reparación y construcción, para férulas o trabajos de ortodoncia, para la activación de bondings/adhesivos, así como para el endurecimiento de barnices de sellado y materiales de bloqueo. Tras la finalización de un trabajo se recomienda realizar generalmente un endurecimiento final en una unidad de fotopolimerización fija, por ejemplo con **EyeEvolution®** o **EyeEvolution® MAX**. **MultiSpot®** se deberá considerar las normas generales de prevención de accidentes.



##### Protección para los ojos:

No se debe mirar directamente a las lámparas LED o iluminar con ellas a otras personas. La intensidad y la longitud de onda pueden ocasionar daños oculares en el caso de un contacto visual prolongado. Por temas de seguridad se deberá usar el anillo antideslumbrante para trabajar. Personas especialmente sensibles deberán usar además las correspondientes gafas de protección.

##### Puesta en marcha

Cargue la batería completamente antes del primer uso. Desenrosque la tapa de cierre de la lámpara con un movimiento circular hacia la izquierda e introduzca la batería con el polo + en dirección LED hasta que haga contacto. Cerrar la tapa de cierre.

##### Manejo

- Presionar el botón de encendido para activar las lámparas LED.
- Posicionar el anillo antideslumbrante lo más cerca posible del material a polimerizar.
- La duración de la luz está limitada a 20 s, quiere decir, pasado este tiempo el aparato se apaga automáticamente. Para iniciar un nuevo proceso de polimerización, presionar el botón de encendido dos veces.
- Este aparato sólo se puede usar conforme al presente manual de instrucciones. No nos responsabilizamos de daños que hayan sido provocados por una manipulación inadecuada o un uso impropio.

Estado de la información: 05 / 2017 / CL


## Español

### Istruzioni d'uso

(IT)

#### MultiSpot®

##### Tasto di avvio

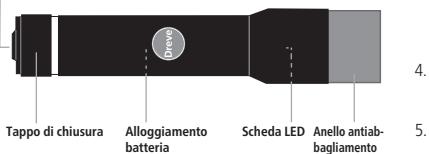

##### Indicazioni

Il dispositivo di polimerizzazione manuale **MultiSpot®** è stato sviluppato specificatamente per il fissaggio e la prepolimerizzazione di tutti i materiali fotoindurenti impiegabili in laboratorio. Il dispositivo manuale senza fili, grazie al sistema DWL, è in particolare adatto a compositi, materiali di costruzione e riparazione per lo splintaggio o per la chirurgia ortognatica, per l'attivazione di bonding e adesivi, così come per l'indurimento di smalti sigillanti e materiali per il fissaggio. A completamento del lavoro, si raccomanda di massima un raddolcimento finale mediante unità fotoindurente fissa, p. es. **EyeEvolution®** o **EyeEvolution® MAX**.



##### Protezione degli occhi:

Il prodotto è stato concepito per un impiego in ambito odontoiatrico e deve essere utilizzato secondo le informazioni d'uso. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni insorgenti da un utilizzo diverso da quello previsto o improprio. Prima dell'utilizzo del dispositivo l'utente è quindi tenuto a verificare autonomamente l'idoneità e le possibilità d'impiego per gli scopi previsti, in particolare quanto tali scopi non rientrano all'interno delle informazioni per l'uso.



##### Smaltimento dei dispositivi secondo direttive WEEE

Rx Only

La direttiva UE 2002/96/CE per la riduzione della quantità crescente dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non più in uso. Lo scopo è evitare, ridurre così come smaltire in modo ecocompatibile le quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici. Lo smaltimento di apparecchiature opportunamente contraddistinte non deve essere effettuato nella spazzatura domestica, bensì nei centri di raccolta comunali, presso il Vostro rivenditore specializzato oppure presso il produttore.

Dreve Design Rev.310517-DU310517-1000-D-3068

## Italiano

**Attenzione:** Quando **MultiSpot®** inizia a lampeggiare, la batteria deve essere ricaricata. Se **MultiSpot®** viene ancora usata, la batteria può essere completamente scarica. La ricarica non è più possibile. La batteria è quindi rotta e deve essere sostituita. Questo porta ad una perdita di diritti di garanzia.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!  
Adatto solo per impiego odontotecnico su calco.

## Multispot®

### Gebrauchsinformation

### Working Instructions

### Mode d'emploi

### Instrucciones de trabajo

### Istruzioni d'uso



CE

Deutsch	Deutsch	Deutsch	English	English	English	French																																											
<b>Gebrauchsinformation</b> <p><b>MultiSpot®</b></p> <p><b>Indikation</b> Das <b>MultiSpot®</b> Handpolymerisationsgerät wurde speziell für die Fixierung und Vorpolymerisation aller im Labor anwendbaren lichthärtenden Materialien entwickelt. Das handliche, kabellose Gerät eignet sich aufgrund des DWL-Systems besonders für Komposite, Aufbau- und Reparaturmaterial für Schienen oder KFO-Arbeiten, zur Aktivierung von Bondings/Adäsiens sowie zur Aushärtung von Versiegelungslacken und Ausblockmaterialien. Grundsätzlich empfiehlt sich nach Abschluss der Arbeiten eine finale Endhärtung in einer stationären Lichthärteeinheit z. B. <b>EyeEvolution®</b> oder <b>EyeEvolution® MAX</b>.</p> <p><b>Technische Daten</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td>max. 132 x 32 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht:</td> <td>ca. 140 gr.</td> </tr> <tr> <td>Akku:</td> <td>3,7 V / 3100 mAh</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ladegerät:</td> <td>Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA</td> </tr> <tr> <td>Polymerisationspeak:</td> <td>385–390 + 465–470 nm</td> </tr> <tr> <td>Zeitakt:</td> <td>20 Sek.</td> </tr> </table> <p><b>Sicherheitshinweise</b></p> <p><b>ACHTUNG!</b> Lesen Sie diese Hinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Die Betriebssicherheit und die Funktion des Gerätes können nur dann gewährleistet werden, wenn sowohl die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers als auch die Sicherheitshinweise in den Bedienungsanleitung beachtet werden.</p> <p><b>Allgemein</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Das Gerät darf nur entsprechend der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, bzw. fehlerhafte Bedienung entstehen.</li> <li>Zugelassene Bediener: Der Betreiber der Maschine muss dem Bediener die Betriebsanleitung zugänglich machen und sich vergewissern, dass er sie gelesen und verstanden hat. Erst dann darf der Bediener das Gerät in Betrieb nehmen.</li> </ol>	Abmessungen:	max. 132 x 32 mm	Gewicht:	ca. 140 gr.	Akku:	3,7 V / 3100 mAh	Leistungsaufnahme		Ladegerät:	Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA	Polymerisationspeak:	385–390 + 465–470 nm	Zeitakt:	20 Sek.	<p><b>Deutsch</b></p> <p><b>Achtung:</b> Beginnt der <b>MultiSpot®</b> zu blinken muss der Akku nachgeladen werden. Bei weiterer Benutzung des <b>MultiSpot</b> kann der Akku tiefentladen werden. Eine Wiederaufladung ist dann nicht mehr möglich. Der Akku ist dann defekt und muss getauscht werden. Dieses führt zu einem Verlust der Garantieleistung.</p> <p><b>Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für die zahntechnische Anwendung auf dem Modell geeignet.</b></p> <p><b>Lieferform</b> <b>REF D38110</b></p> <p><b>MultiSpot®</b> 1 x <b>MultiSpot®</b> Handlampe 1 x Li-Ion Akku 3,7 V / 3100 mAh 1 x Akku-Ladegerät 1 x Anleitung</p> <p><b>Zubehör</b> <b>REF D38111</b> Blendschutzringe 3 Stück <b>REF D38112</b> Li-Ion Akku 3,7 V / 3100 mAh <b>REF D38113</b> 1 Stück Akku-Ladegerät 1 Stück</p> <p><b>Augenschutz:</b> Niemals direkt in die LED Leuchten blicken oder andere Menschen direkt anstrahlen. Die Intensität und die Wellenlängen können bei längerem direktem Blickkontakt zu Schäden an den Augen führen. Zur Sicherheit nur mit aufgesetztem Blendschutzring arbeiten. Besonders sensible Personen sollten zusätzlich eine entsprechende Schutzbrille tragen.</p> <p><b>Inbetriebnahme</b> Laden Sie den mitgelieferten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Verschlusskappe der Lampe durch Linksdrehung öffnen und den Akku mit dem + Pol in Richtung der LED bis auf Kontakt einschieben. Verschlusskappe wieder aufzuschrauben.</p> <p><b>Bedienung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Starttaste drücken um die LEDs zu aktivieren.</li> <li>Blendschutzhilfe möglichst nahe an dem zu polymerisierenden Material positionieren.</li> <li>Die Leuchtdauer ist auf 20 Sek. begrenzt, d. h. nach diesem Zeitraum schaltet sich das Gerät automatisch ab. Um einen erneuten Polymerisationsprozess zu starten, Starttaste 2 x betätigen.</li> <li>Eine ablaufende Polymerisationszeit kann auch durch Druck auf die Starttaste abgebrochen werden. In diesem Fall ist für einen Neustart die Starttaste nur 1 x zu drücken.</li> </ul> <p>Stand der Information: 05 / 2017 / CL</p>	<p><b>Deutsch</b></p> <p><b>Achtung:</b> Beginnt der <b>MultiSpot®</b> zu blinken muss der Akku nachgeladen werden. Bei weiterer Benutzung des <b>MultiSpot</b> kann der Akku tiefentladen werden. Eine Wiederaufladung ist dann nicht mehr möglich. Der Akku ist dann defekt und muss getauscht werden. Dieses führt zu einem Verlust der Garantieleistung.</p> <p><b>Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nur für die zahntechnische Anwendung auf dem Modell geeignet.</b></p> <p><b>Lieferform</b> <b>REF D38110</b></p> <p><b>MultiSpot®</b> 1 x <b>MultiSpot</b> manual lamp 1 x Li-ion rechargeable battery 3,7 V / 3100 mAh 1 x battery charger 1 x instruction manual</p> <p><b>Indication</b> The <b>MultiSpot®</b> manual polymerisation unit has been developed specifically for hardening and pre-polymerisation of all light-cured materials used in the laboratory. Thanks to its DWL system, the handy cordless unit is particularly suitable for composites, material for producing and repairing splints or orthodontic work, for the activation of bonding/adhesives, as well as for curing sealing lacquers and blocking out material. Final softening in a stationary light-curing unit, e. g. <b>EyeEvolution®</b> oder <b>EyeEvolution® MAX</b> is recommended after all tasks have been completed.</p> <p><b>Technical data</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensions:</td> <td>max. 132 x 32 mm</td> </tr> <tr> <td>Weight:</td> <td>ca. 140 gr.</td> </tr> <tr> <td>Rechargeable battery:</td> <td>3,7 V / 3100 mAh</td> </tr> <tr> <td>Power consumption</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Battery charger:</td> <td>Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA</td> </tr> <tr> <td>Polymerisation peak:</td> <td>385–390 + 465–470 nm</td> </tr> <tr> <td>Time intervals:</td> <td>20 sec.</td> </tr> </table> <p><b>Putting into operation</b> Fully charge the rechargeable battery supplied with the unit before first use. Open the end cap of the lamp by twisting it anticlockwise and insert the rechargeable battery with its + pole pointing in the direction of the LED until it makes contact. Screw the end cap back on.</p> <p><b>Safety instructions</b></p> <p><b>ATTENTION!</b> Please read these instructions carefully before you start to use the unit. The operational safety and function of the unit can only be guaranteed if both the general safety and accident prevention provisions issued by the statutory body and the safety instructions in the operating manual are complied with.</p> <p><b>General information</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The unit must only be used in accordance with the current operating manual. We reject any liability for damage caused by inappropriate use or errors during operation.</li> <li>Ongoing polymerisation procedures can be interrupted by pressing on the start button. In this case, the start button only needs to be pressed once to start a new process.</li> </ol> <p>Information last revised: 05 / 2017 / CL</p>	Dimensions:	max. 132 x 32 mm	Weight:	ca. 140 gr.	Rechargeable battery:	3,7 V / 3100 mAh	Power consumption		Battery charger:	Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA	Polymerisation peak:	385–390 + 465–470 nm	Time intervals:	20 sec.	<p><b>Working Instructions</b></p> <p><b>EN</b></p> <p><b>MultiSpot®</b></p> <p><b>Keep out of reach and sight of children! Only suitable for dental applications on the model.</b></p> <p><b>Form of delivery</b> <b>REF D38110</b></p> <p><b>MultiSpot®</b> 1 x <b>MultiSpot</b> manual lamp 1 x Li-ion rechargeable battery 3,7 V / 3100 mAh 1 x battery charger 1 x instruction manual</p> <p><b>Accessories</b> <b>REF D38111</b> 3 anti-glare hoods <b>REF D38112</b> 1 Li-ion battery 3,7 V / 3100 mAh <b>REF D38113</b> 1 battery charger</p> <p><b>Indication</b> The <b>MultiSpot®</b> manual polymerisation unit has been developed specifically for hardening and pre-polymerisation of all light-cured materials used in the laboratory. Thanks to its DWL system, the handy cordless unit is particularly suitable for composites, material for producing and repairing splints or orthodontic work, for the activation of bonding/adhesives, as well as for curing sealing lacquers and blocking out material. Final softening in a stationary light-curing unit, e. g. <b>EyeEvolution®</b> ou <b>EyeEvolution® MAX</b> is recommended after all tasks have been completed.</p> <p><b>Eye protection:</b> Always avoid looking directly at the LEDs and never point them at other people. The intensity and wavelengths can cause damage to the eyes after prolonged direct visual contact. For safety reasons, always only work with the mounted anti-glare hood. People who are particularly sensitive should also wear appropriate protective glasses.</p> <p>This product has been developed for use in the field of dentistry and must be used in accordance with the instruction manual. The manufacturer rejects any liability for damage arising from use in other applications or non-appropriate use. In addition, the user is under the obligation to independently check the product for its suitability and potential application for the intended purposes prior to using the unit, especially if these purposes are not listed in the instruction manual.</p> <p><b>Putting into operation</b> Fully charge the rechargeable battery supplied with the unit before first use. Open the end cap of the lamp by twisting it anticlockwise and insert the rechargeable battery with its + pole pointing in the direction of the LED until it makes contact. Screw the end cap back on.</p> <p><b>Safety instructions</b></p> <p><b>ATTENTION!</b> Please read these instructions carefully before you start to use the unit. The operational safety and function of the unit can only be guaranteed if both the general safety and accident prevention provisions issued by the statutory body and the safety instructions in the operating manual are complied with.</p> <p><b>General information</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The unit must only be used in accordance with the current operating manual. We reject any liability for damage caused by inappropriate use or errors during operation.</li> <li>Ongoing polymerisation procedures can be interrupted by pressing on the start button. In this case, the start button only needs to be pressed once to start a new process.</li> </ol> <p>Information last revised: 05 / 2017 / CL</p>	<p><b>Mode d'emploi</b></p> <p><b>FR</b></p> <p><b>MultiSpot®</b></p> <p><b>Indication</b> L'appareil de polymérisation manuelle <b>MultiSpot®</b> a été spécialement conçu pour la fixation et pré-polymérisation de tous les matériaux photopolymérisables et utilisables dans le laboratoire. Cet appareil sans fil et toujours à portée de main se base sur le système DWL notamment pour les composites, les matériaux de construction et de réparation pour les éléments de fixation (orthèses) ou les travaux d'orthodontie, pour permettre le collage / l'adhérence et pour le durcissement des laques et des matériaux d'étalement. En principe, un adoucissement final dans une unité de photopolymérisation fixe comme par exemple <b>EyeEvolution®</b> ou <b>EyeEvolution® MAX</b>, une fois les opérations terminées est conseillé.</p> <p><b>Protection des yeux :</b> Ne regardez jamais directement les lampes LED et évitez d'éblouir d'autres personnes. L'intensité et la longueur d'où peuvent causer des lésions oculaires après un contact direct prolongé des yeux. Pour la sécurité optimale, travaillez uniquement avec l'écran protecteur anti-éblouissement monté. Les personnes particulièrement sensibles doivent également porter une protection oculaire appropriée.</p> <p><b>Spécifications techniques</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Dimensions :</td> <td>132 x 32 mm maxi.</td> </tr> <tr> <td>Poids :</td> <td>env. 140 gr.</td> </tr> <tr> <td>Batterie :</td> <td>3,7 V / 3100 mAh</td> </tr> <tr> <td>Puissance absorbée</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chargeur :</td> <td>Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Plage de polymérisation :</td> <td>Sortie : 5,0 V / 1000 mA</td> </tr> <tr> <td>Cycle de polymérisation :</td> <td>385–390 + 465–470 nm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>20 s.</td> </tr> </table> <p><b>Mise en service</b> Chargez totalement la batterie fournie avant la première utilisation. Ouvrez le capuchon de protection de la lampe en le tournant vers la gauche pour le desserrer et insérez la batterie avec le pôle + vers la LED jusqu'à ce que le contact soit établi. Révissez le capuchon de protection.</p> <p><b>Consignes de sécurité</b></p> <p><b>ATTENTION !</b> Lisez attentivement ces instructions avant la mise en service de l'appareil. La fiabilité et la fonctionnalité de l'appareil ne peuvent être garanties que si les normes de sécurité générale et les normes pour la prévention des accidents du législateur sont observées en plus des consignes de sécurité de cette notice.</p> <p><b>Généralités</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le dispositif ne peut être utilisé que conformément aux instructions données dans ce manuel. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou un fonctionnement défaillant.</li> </ol>	Dimensions :	132 x 32 mm maxi.	Poids :	env. 140 gr.	Batterie :	3,7 V / 3100 mAh	Puissance absorbée		Chargeur :	Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz	Plage de polymérisation :	Sortie : 5,0 V / 1000 mA	Cycle de polymérisation :	385–390 + 465–470 nm		20 s.	<p>2. Utilisateurs autorisés : L'opérateur qui utilise l'appareil doit veiller à ce que la notice d'utilisation soit toujours accessible et que l'utilisateur a bien lu et compris les instructions et consignes données. L'appareil ne peut être mis en service que si toutes ces conditions sont remplies.</p> <p>3. Avant toute utilisation, l'opérateur doit impérativement vérifier le parfait état de marche de l'appareil ainsi que sa fiabilité. Si l'appareil s'avère défectueux, il ne doit en aucun cas être utilisé. Son état doit être marqué en conséquence.</p> <p>4. Utilisez uniquement le chargeur fourni, d'autres chargeurs peuvent causer des dommages et la défaillance de la batterie.</p> <p>5. Les plaquettes et les autocollants doivent toujours être à l'état visible. Ne jamais les enlever.</p> <p>6. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange qui sont approuvés par le fabricant. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages causés par l'utilisation de pièces non approuvées.</p> <p>7. Toute transformation ou modification abusive n'est pas non autorisée pour des raisons de sécurité.</p> <p>8. L'utilisation prévue et les consignes et instructions de cette notice d'utilisation doivent scrupuleusement être respectées. Lorsque vous travaillez avec <b>MultiSpot®</b>, les normes générales de prévention des accidents doivent être scrupuleusement respectées.</p> <p><b>Protection des yeux :</b> Ne regardez jamais directement les lampes LED et évitez d'éblouir d'autres personnes. L'intensité et la longueur d'où peuvent causer des lésions oculaires après un contact direct prolongé des yeux. Pour la sécurité optimale, travaillez uniquement avec l'écran protecteur anti-éblouissement monté. Les personnes particulièrement sensibles doivent également porter une protection oculaire appropriée.</p>
Abmessungen:	max. 132 x 32 mm																																																
Gewicht:	ca. 140 gr.																																																
Akku:	3,7 V / 3100 mAh																																																
Leistungsaufnahme																																																	
Ladegerät:	Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA																																																
Polymerisationspeak:	385–390 + 465–470 nm																																																
Zeitakt:	20 Sek.																																																
Dimensions:	max. 132 x 32 mm																																																
Weight:	ca. 140 gr.																																																
Rechargeable battery:	3,7 V / 3100 mAh																																																
Power consumption																																																	
Battery charger:	Input: 100–240 V, 50/60 Hz Output: 5,0 V / 1000 mA																																																
Polymerisation peak:	385–390 + 465–470 nm																																																
Time intervals:	20 sec.																																																
Dimensions :	132 x 32 mm maxi.																																																
Poids :	env. 140 gr.																																																
Batterie :	3,7 V / 3100 mAh																																																
Puissance absorbée																																																	
Chargeur :	Entrée : 100–240 V, 50/60 Hz																																																
Plage de polymérisation :	Sortie : 5,0 V / 1000 mA																																																
Cycle de polymérisation :	385–390 + 465–470 nm																																																
	20 s.																																																